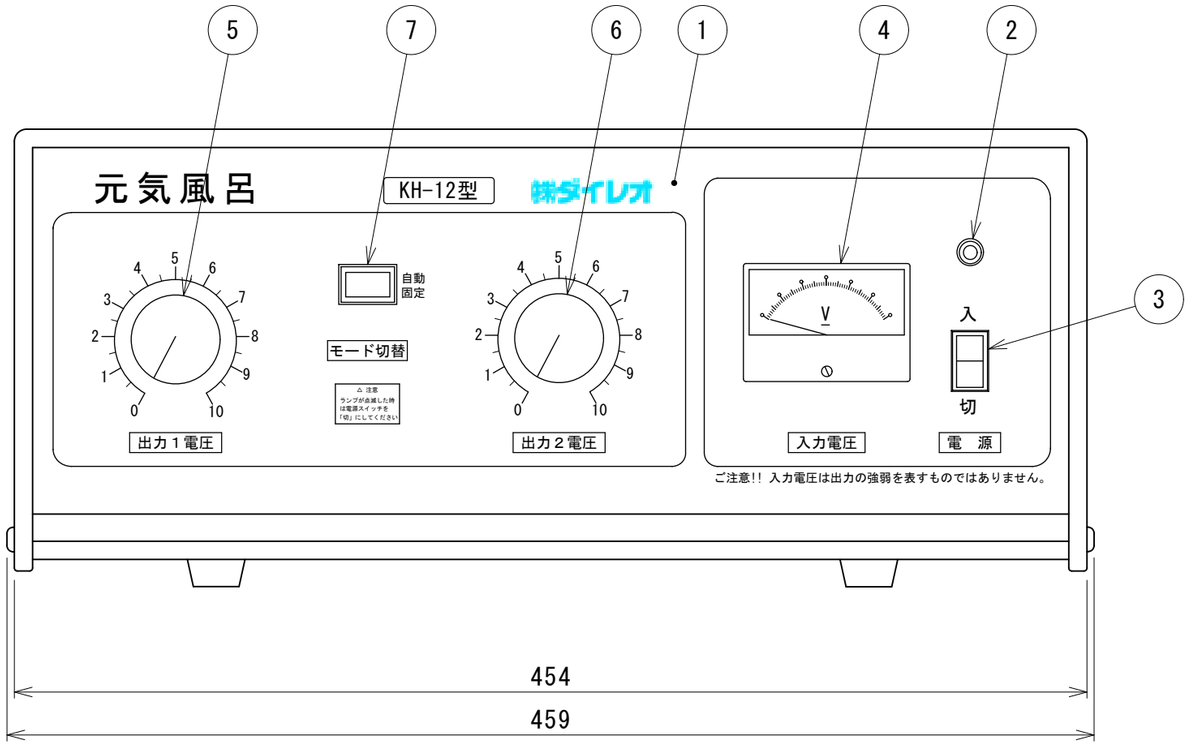

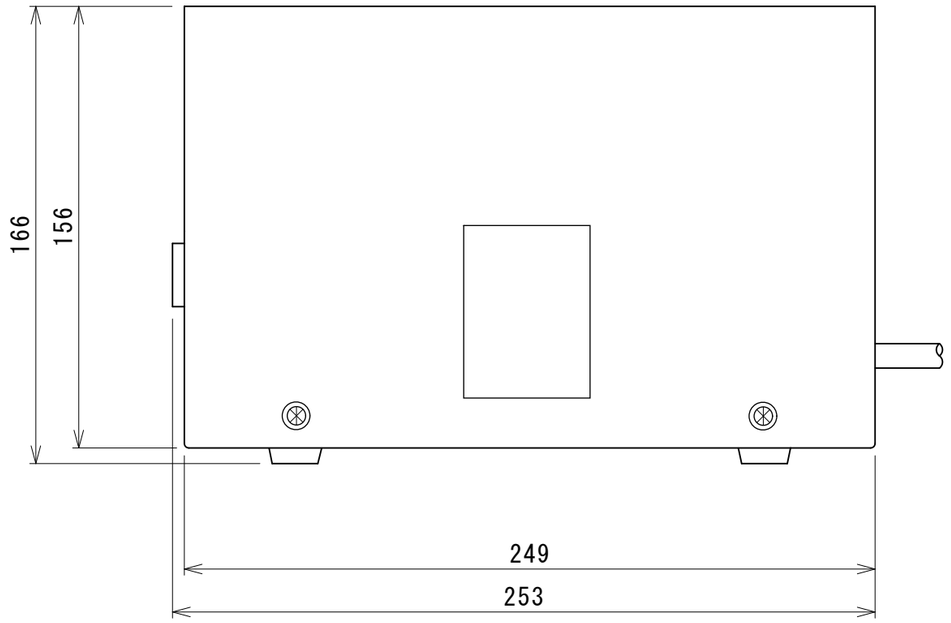

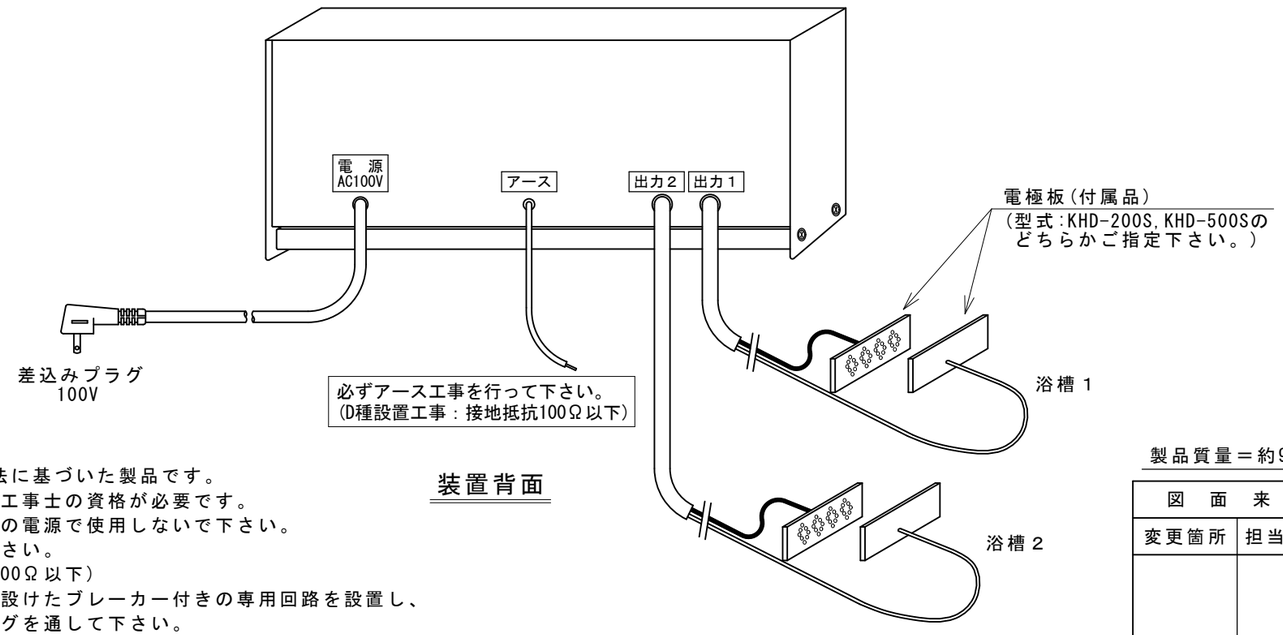

装置背面

－注記－
1. 経済産業省 電気用品安全法に基づいた製品です。
2. この製品の施工には、電気工事士の資格が必要です。
3. 定格電圧・定格周波数以外の電源で使用しないで下さい。
4. 必ずアース工事を行って下さい。
（D種設置工事：接地抵抗100Ω以下）
5. 電源は、必ず漏電遮断器を設けたブレーカー付きの専用回路を設置し、
コンセントから差込みプラグを通して下さい。
6. ペースメーカー等の体内埋込型医療用電子機器を使用されている人や、
心臓病の方等が安易にご使用にならない様、注意書看板を設置して下さい。
7. 電極板にSUS304を使用している為、水質により腐食を起こす恐れがあります。
チタン製の対応等も行っておりますので、詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

－付属品－
・電極板：２対（４枚）（取付ネジ付属）
・注意書看板：２枚（取付ネジ付属）
・取扱説明書

製品質量＝約9.8kg

高濃度温泉用

品番	部品名称	材質	数量	適要
7	モード切替スイッチ		1	自動/固定 切替用
6	出力調節器（出力２）		1	可変抵抗器式
5	出力調節器（出力１）		1	可変抵抗器式
4	電源電圧計		1	FS DC10V CLASS2.5
3	電源スイッチ		1	6A125VAC 両切式
2	電源ランプ		1	AC100V 1mA 緑色
1	前面パネル	アルミニウム（A-1050）	1	t1.5 HL･アルマイト加工

図面来歴		
変更箇所	担当	日付

承認	中山	図面名称	型式 KH-12SP 元気風呂電源装置（高濃度温泉用）
審査	中山		
設計	庵下	株式会社ダイレオ	
製図	奥田	尺度	図面番号 KH-12SP
日付	2012/07/13	―	親図面 SP1024M　サイズ A３